


■ INPUT設定値 (メーター80%)

12AX7 1.1
 12AX7A 1.0
 6BQ5 0.7
 6SN7 0.7

PCL86 (3)1.2 (5)0.8
 6BM8 (3)0.8 (5)1.2

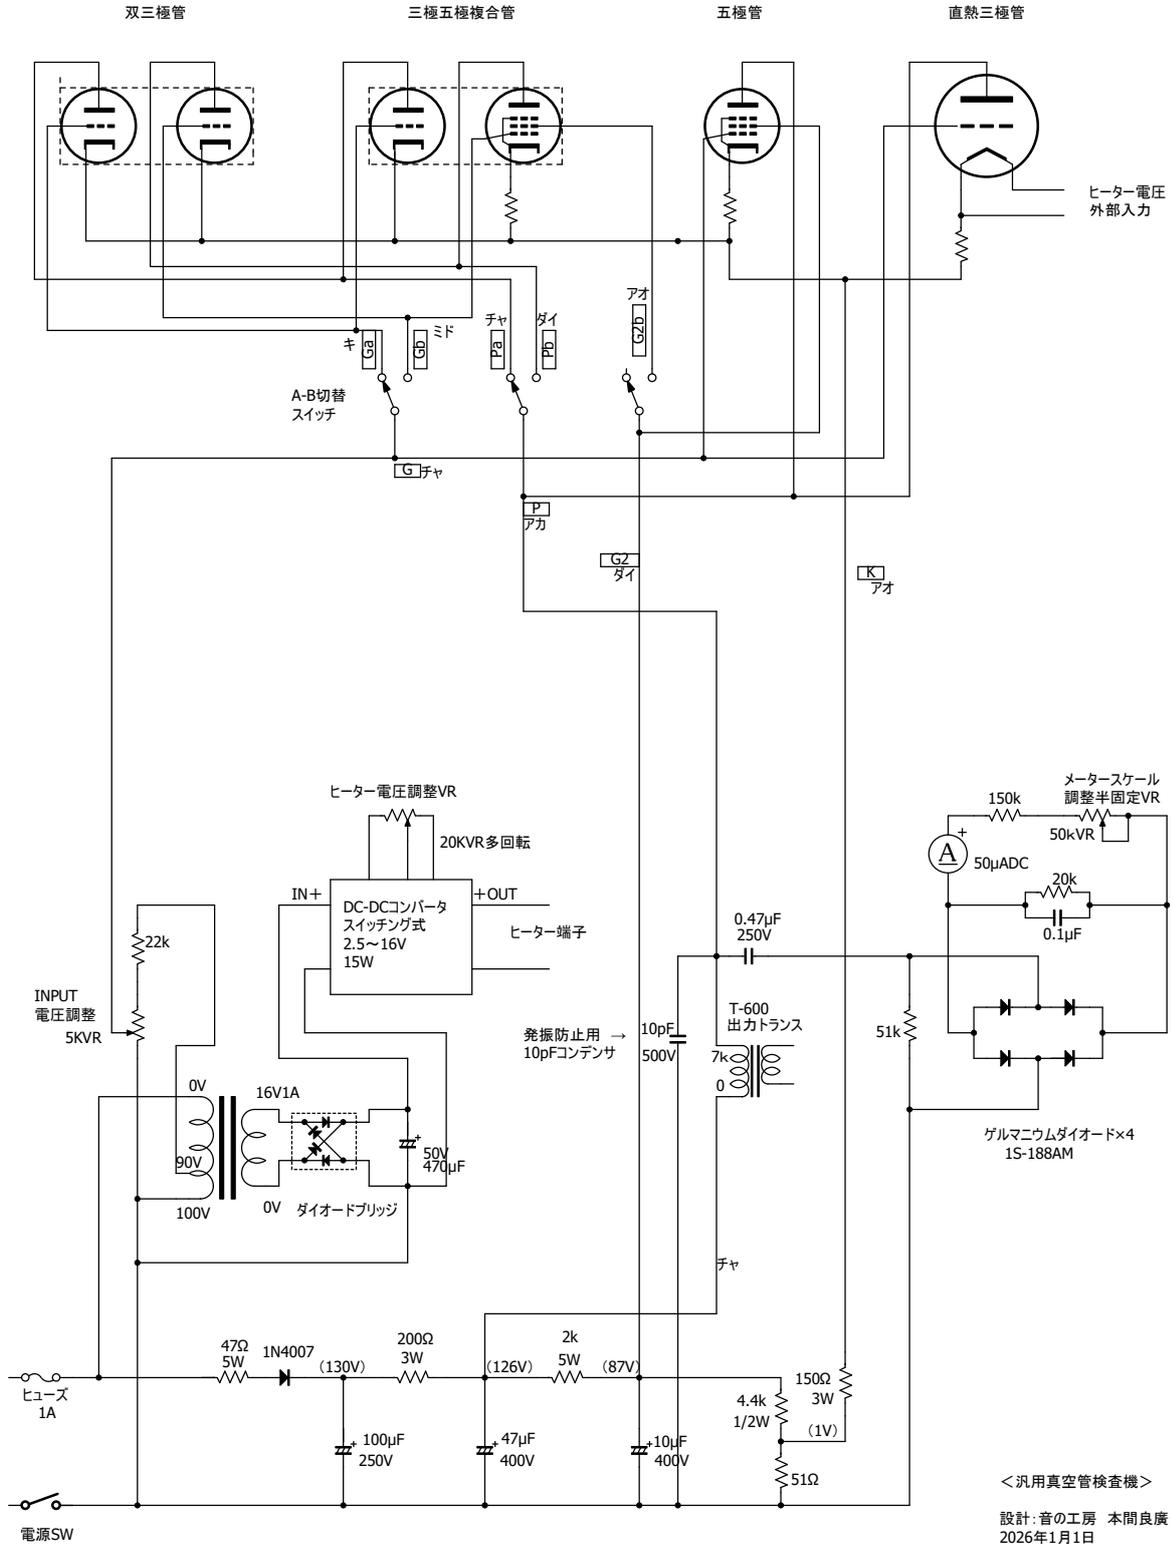

< 汎用真空管検査機 >
 設計: 音の工房 本間良廣
 2026年1月1日
 2026年1月9日
 2026年1月27日